




Telef. 622600 / 622449 Telex 37047 MILBON P

Telefax (034) 601736 Apart. 45 3751 ÁGUEDA

PORTUGAL

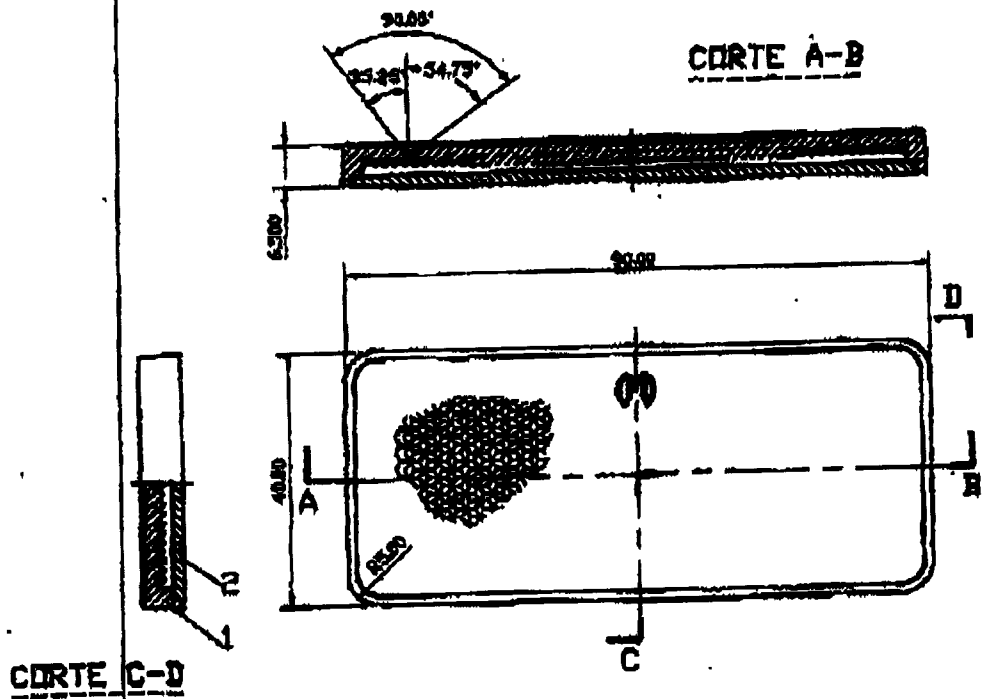

LABORATÓRIO CENTRAL OFICIAL  
 DE ELECTROTÉCNICA C. I. S. L. I.  
 DOCUMENTAÇÃO ANEXA AL  
 INFORME N.º 96/04/34

Art-Bez.: R118

Art-M.: 31.0005.501-521

Todos os direitos de propriedade nos estão reservados.  
 Proibido copiar ou debitar em poder de terceiros sem nossa permissão escrita.

Nr.	Quant	Designação	Material	Nr. Norma
2	1	BASE	ABS	
1	1	VIDRO	ACRILICO	
Escalas			Data: 20/05/88	Des. J. Gonçalves
Nr. Desenho:			Verif.	

31.0005.501-521

**CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE UN TIPO DE DISPOSITIVO  
CATADIOPTRICO /**

**Certificat d'homologation d'un type de dispositif catadioptrique**

Reglamento n° 3 ECE

N° de homologación: IA\*E9\*02.4006

1. Marca de fábrica o de comercio / Marque de fabrique ou de commerce: MIL 450072/4/6
2. Clase / Classe: IA. ROJO / AMARILLO AUTO / BLANCO
3. Nombre del fabricante / Nom du fabricant: MIRANDA IRMAO LDA.
4. Dirección / Adresse: 3751- AGUEDA, APTO. 45- BARRALIA ( PORTUGAL )
5. Eventualmente nombre de un representante / Le cas échéant, nom d'un représentant: - -
6. Dirección / Adresse: - -
7. Presentado a homologación el / Présenté pour l'homologation le: octubre /96
8. Laboratorio de ensayos: L.C.O.E.
9. Fecha y número del certificado del laboratorio / Date et numéro du certificat du laboratoire:  
15-10-96/ 96104134
10. Fecha de homologación / Date d'homologation: 17-10-96
11. Fecha de extensión de homologación / Date d'extension d'homologation: - - -
12. Fecha de las deducciones / Date des procès-verbaux du laboratoire: - -
13. Laboratorio de ensayos / laboratoire des essais: - -
14. Fecha y números del certificado del laboratorio: - -
15. Fecha de retirada / Date du retrait:
16. Observaciones / Remarques:

"EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL"



D. Antonio Muñoz Muñoz.  
Resolución P.D. 03-09-96

